INFORMACJE OGÓLNE

Nebulizator MB5, zamienia płynną postać leku w aerozol, który ze względu na rozmiar generowanych cząstek, ma zdolność depozycji w drzewie oskrzelowym i pęcherzykach płucnych.

- MB5 jest nebulizatorkiem jednego użytkownika i nie może być używany przez inne osoby. Nie może być sterylizowany.
- MB5 powinien być używany do jednego rodzaju leku.
- Źródłem sprężonego powietrza powinien być kompresor (lub inne źródło sprężonego powietrza) generujące ciśnienie w przedziale 1,5 do 3 bar i przepływ powietrza od 7 do 15 l/min.
- W zależności od powyższych parametrów, czas inhalacji trwać będzie od 12 do 5 min (2 ml soli fizjologicznej).
- Bez względu na czas inhalacji rozkład wielkości generowanych cząstek aerozolu pozostanie bez zmian. Średnia wielkość wynosi 1,7 - 2,5 mikrometra (MMAD).

UŻYTKOWANIE NEBULIZATORA MB5

Upewnij się, że nebulizator jest dokładnie wymyty po ostatnim jego użytkowaniu.

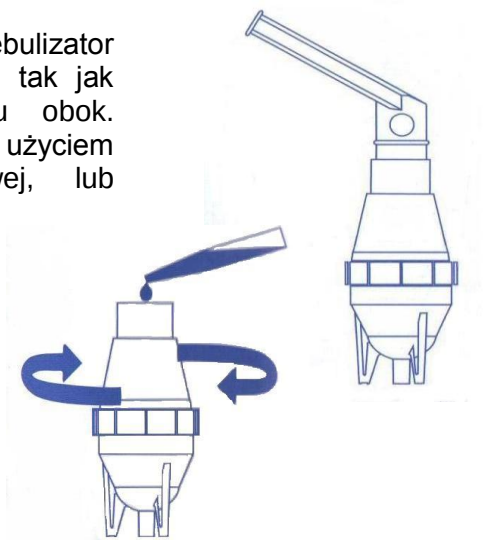

- Napełnij nebulizator odmierzoną porcją leku tak jak pokazano na rysunku obok. (Napełniając od góry z użyciem strzykawki jednorazowej, lub wlewając po rozkręceniu zbiornika na lek).
- Dołącz ustnik, końcówkę donosową lub maskę twarzową.
- Utrzymuj nebulizator w pozycji pionowej podczas nasuwania rurki łączącej na króciec od spodu nebulizatora oraz do kompresora.

PROWADZENIE INHALACJI

- Inhalację należy prowadzić w pozycji siedzącej.
- Przed przystąpieniem do inhalacji wykonać należy serię spokojnych wdechów i wydechów.
- Należy umieścić ustnik między zębami, obejmując go ściśle wargami.
- Po włączeniu kompresora, z nebulizatora wydobywa się gęsta mgła. Wdech i wydech odbywa się bez wyjmowania końcówki inhalatora z ust. Oddychać należy spokojnie i głęboko. Wydychane powietrze wychodzi na zewnątrz przez otwór z boku ustnika.
- Zużycie pełnej porcji leku można zidentyfikować zmianą tonacji dźwięku. Dla pewności należy sprawdzić, czy z nebulizatorka wydobywa się mgła.

MYCIE NEBULIZATORKA MB5

Po każdej inhalacji w nebulizatorze pozostają resztki leku, które bezwzględnie należy usunąć.

Nebulizatorek musi być myty po każdym jego użyciu, w sposób następujący:

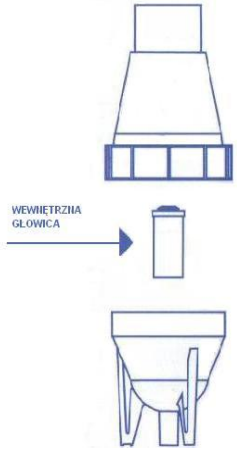

1. Odłącz wężyk łączący,
2. Wyjmij ustnik (lub maskę),
3. Odkręć górną część zbiornika na lek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
4. Wyjmij wewnętrzną głowicę (jak na rys. obok),
5. Wymyj wszystkie części w gorącej wodzie (do 60°C) z dodatkiem lekkiego detergentu,
6. Wypłucz pod bieżącą wodą, strząśnij jej nadmiar i pozostaw do wyschnięcia.
7. Po wyschnięciu połącz wszystkie części,
8. Wilgoć z wężyka usuniesz włączając na krótko sprężarkę.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

NEBULIZATOR MB5 do terapii dolnych dróg oddechowych

CE 0051

Producent:
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.
Via dei Prati, 62, 25073 Bovezzo (Bs) Italy
Tel.:+39 /030 20159 11, Fax: +39/030 200 05 51
www.airliquidemedicalsystems.it

Dystrybutor:
SECURA NOVA sp. z o. o.
Al. 3 Maja 2/4 , 00-391 Warszawa
Tel./fax : /22/ 625 61 43, /22/622- 96 68
www.securanova.com.pl